# Теплосчетчик «Пульсар» с одним расходомером
# Структура меню (Ред. 5.1.4)

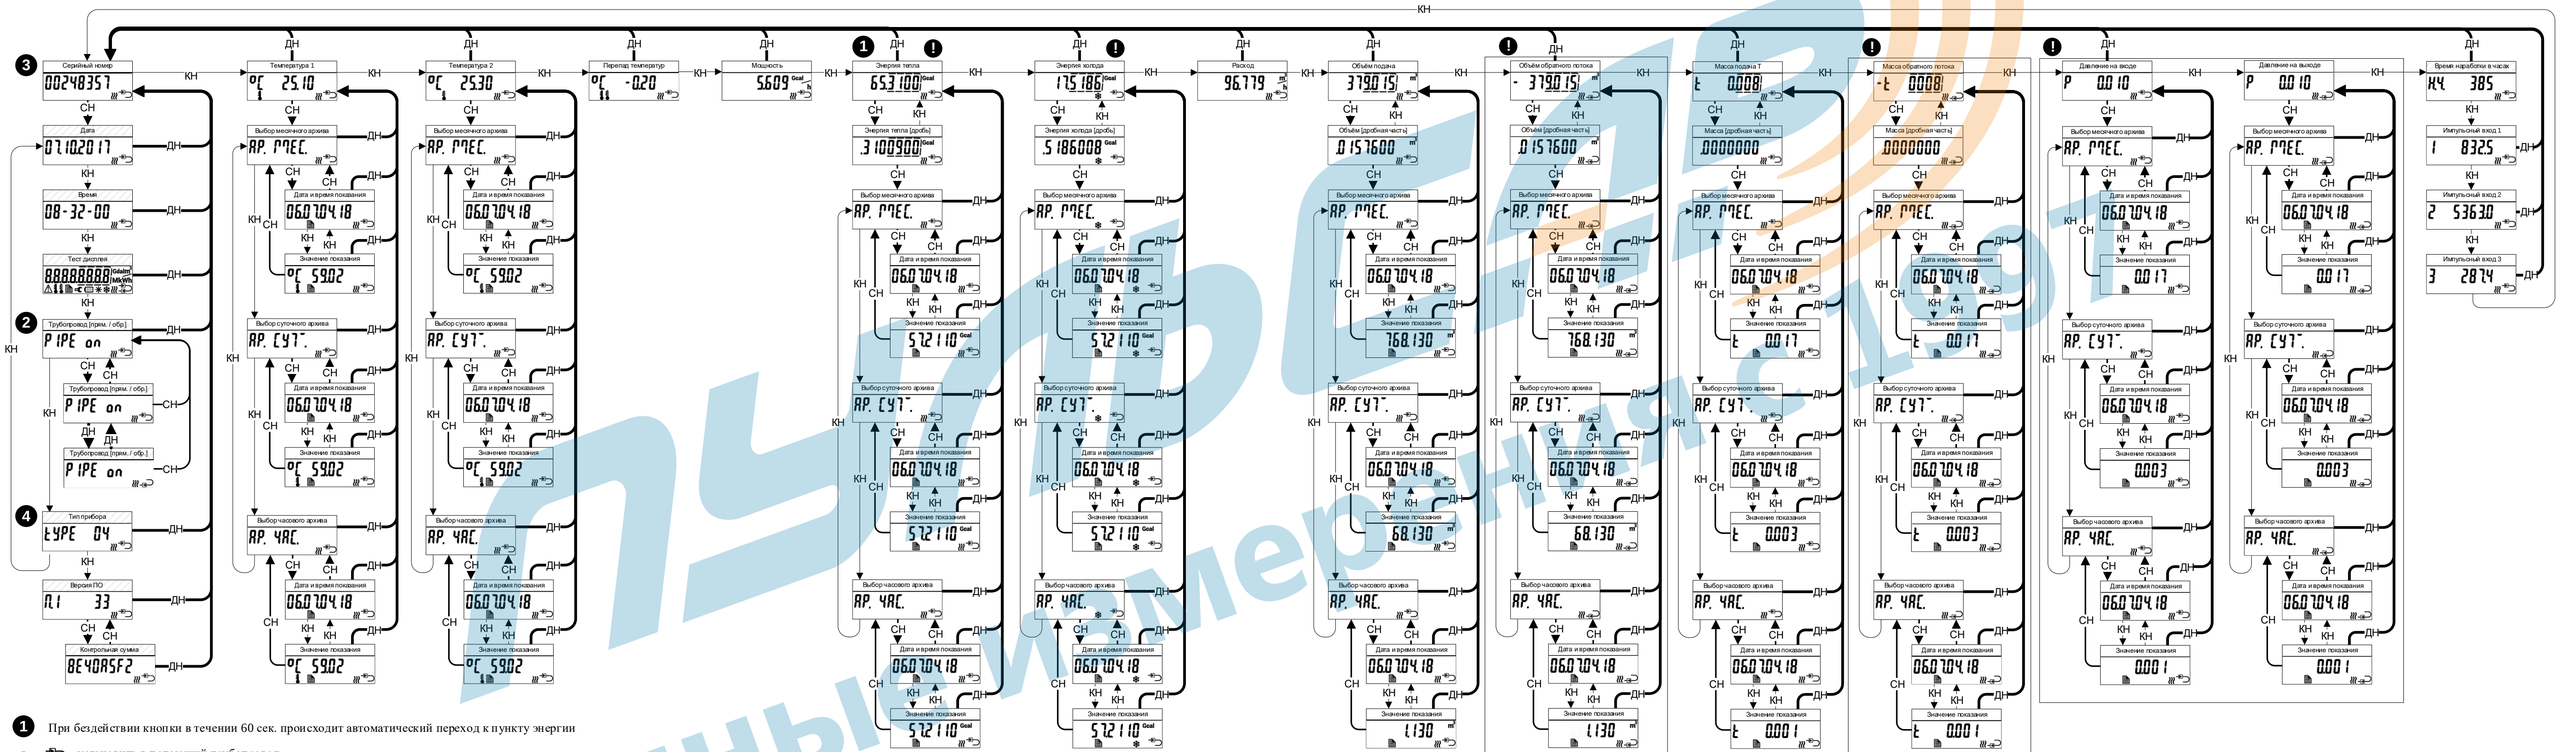


1. При бездействии кнопки в течении 60 сек. происходит автоматический переход к пункту энергии
2. - установить в подающий трубопровод
   - установка в обратный трубопровод
   - on - есть возможность переключения подающий/обратный
   - oFF - нет возможности переключения подающий/обратный
3. **- счетчик тепла**
   **- счетчик холода**
   **- комбинированный счетчик тепла/холода**
4. **04** - счетчик тепла, с расчетом массы. Расчетная формула Q=M1(h1-h2)

! Может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

КН — короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

СН — среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

ДН — длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек

ПУЛЬСАР
умные измерения