

Приложение В

Требования к длине прямых участков (ред.2)

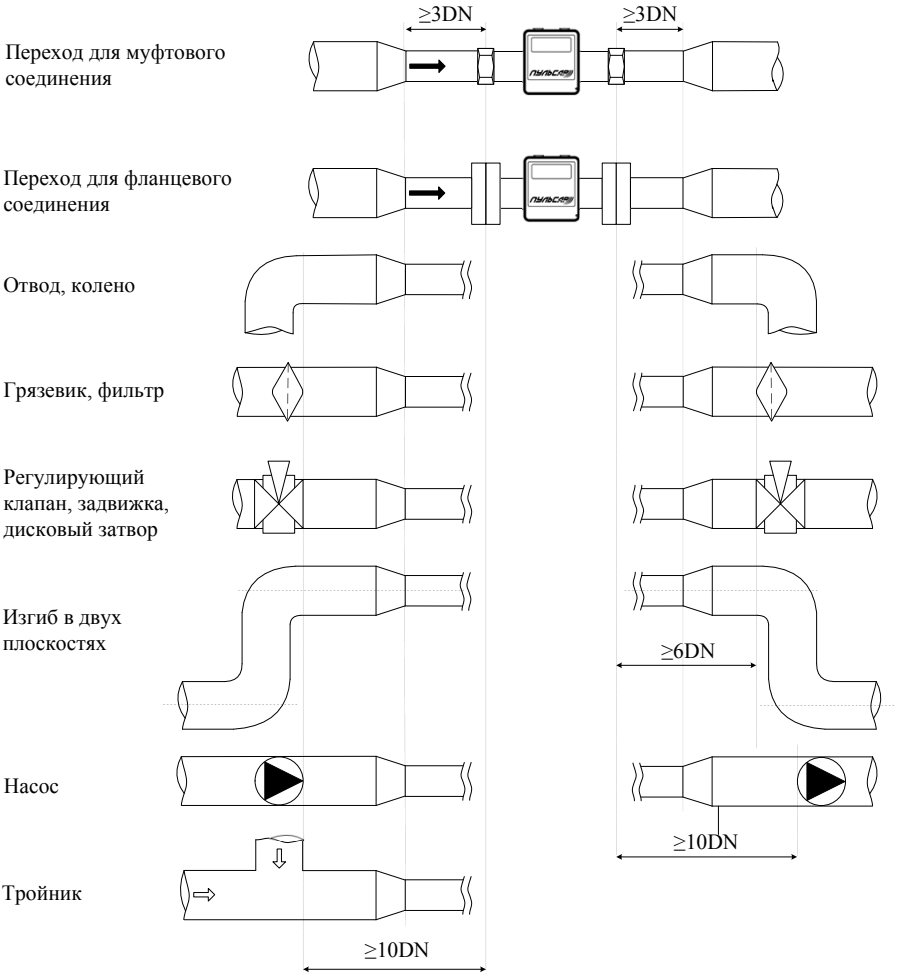

Приложение Г

Структура меню (ред. 4.6)
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар»

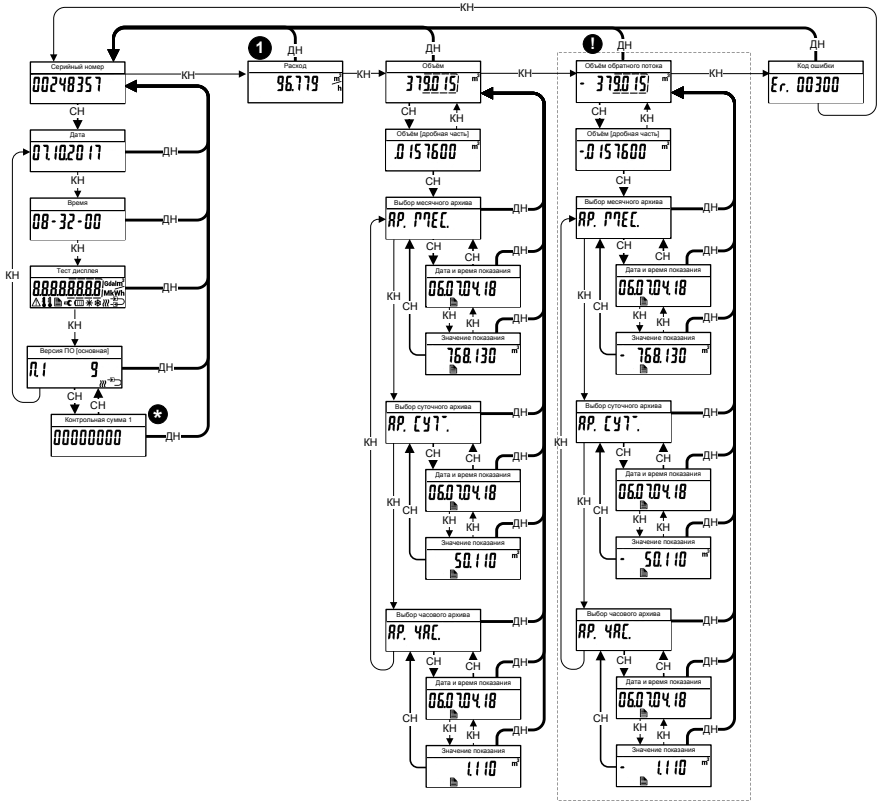

* значение контрольной суммы
8E40A5F2 – без интерфейсов/импульсный выход/интерфейсы M-Bus/RS-485
4F135A7B – радиовыход IoT
C42AD38E – радиовыход LoRa
D37DD26F – радиовыход WM-Bus

1 при бездействии кнопки в течение 60 с. происходит автоматический переход к пункту объём

! может отсутствовать в зависимости от модификации прибора

—КН→ короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

—СН→ среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

—ДН→ длинное нажатие на кнопку длительностью более 2.5 сек